


ピペットサービスのフローチャート

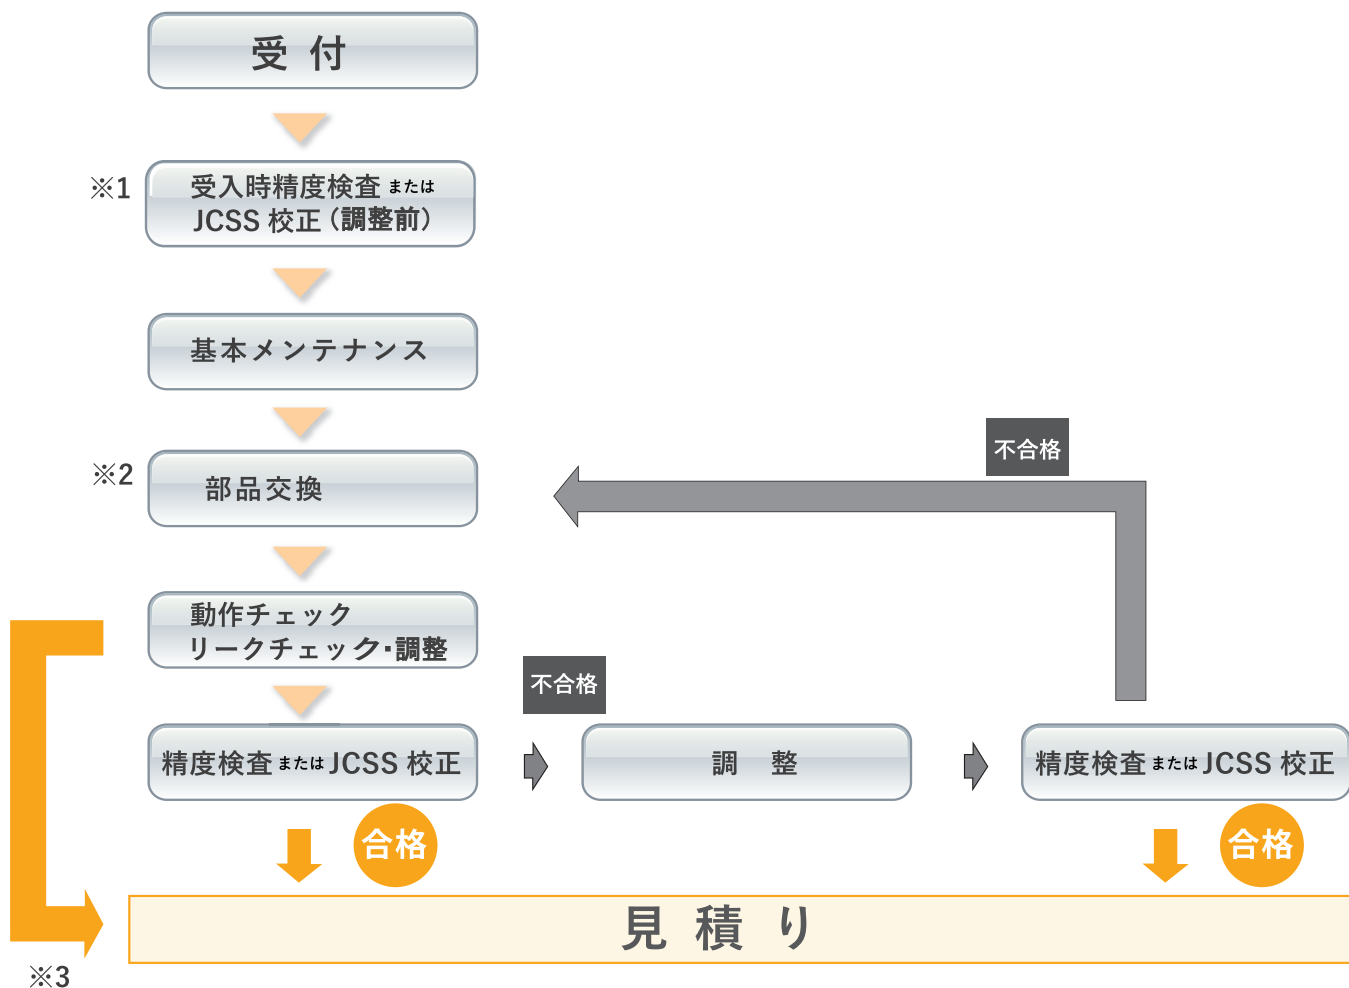

5～7営業日程度で販売店様へお見積致します。

※1) 弊社受け入れ時（ピペットお預かり時）に、調整前のJCSS校正、もしくは精度検査を依頼される場合となります。

※2) 部品交換が必要な場合のみ実施致します。（弊社製品のみ対応）

※3) Midi Plus（ピペットコントローラー）または精度測定不能品の場合は精度確認せずお見積となります。

Pipette Doctor (点検 / メンテナンス)

測定ポイント： 2ポイント（ピペットの最大容量の100%と10%もしくは最小設定容量）で、5回測定。
 合否判定： 試験はISO8655の最大許容誤差または、メーカー基準と比較して合否の判定を行います。
 （必要に応じて調整を行います。）
 受入検査： 点検/メンテナンス実施前（受入時）の精度検査。

Pipette Doctor (点検/メンテナンス)			添付書類		
チャンネル	サービス内容	価格	サービス報告書	精度検査成績書	受入時精度検査成績書
1ch	Pipette Doctor 1ch 2点5回測定	¥4,500	●	●	
	Pipette Doctor 1ch 2点5回測定 受入検査あり	¥7,500	●	●	●
8ch	Pipette Doctor 8ch 2点5回測定	¥11,000	●	●	
	Pipette Doctor 8ch 2点5回測定 受入検査あり	¥17,500	●	●	●
12ch	Pipette Doctor 12ch 2点5回測定	¥14,000	●	●	
	Pipette Doctor 12ch 2点5回測定 受入検査あり	¥22,500	●	●	●

JCSS 校正 (トレーサビリティの確保された校正)

測定ポイント： 3ポイント（ピペットの最大容量の100%、50%、10%もしくは最小設定容量）で、10回測定。
 合否判定： 試験はISO8655の最大許容誤差または、メーカー基準と比較して合否の判定を行い、
 合否判定試験成績書を発行します。（必要に応じて調整します。）
 受入校正： 点検/メンテナンス実施前（受入時）に行うJCSS校正です。

Note) マルチチャンネル（8ch、12ch）の場合、代表する1チャンネルのみを校正します。
 全チャンネルの測定データが必要な場合、合否判定試験をご依頼下さい。

★ ISO9001, ISO15189, ISO/IEC17025 や JIS、薬局方、GMP/GLP など各種規格や法規に準拠するためにはこちらを選択ください。

JCSS 校正			添付書類					
チャンネル		サービス内容	価格	サービス報告書	JCSS校正証明書(調整前)	受入時合否判定成績書	JCSS校正証明書(調整後)	合否判定試験成績書
1ch		JCSS 校正 1ch 3点 10回測定	¥14,000	●			●	
	★	JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 合否判定付き	¥17,000	●			●	●
		JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 調整前校正付き	¥25,000	●	●		●	
	★	JCSS 校正 1ch 3点 10回測定 調整前校正+合否判定付き	¥28,000	●	●	●	●	●
8ch		JCSS 校正 8ch 3点 10回測定	¥22,000	●			●	
	★	JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 合否判定付き	¥33,000	●			●	●
		JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 調整前校正付き	¥43,000	●	●		●	
	★	JCSS 校正 8ch 3点 10回測定 調整前校正+合否判定付き	¥54,000	●	●	●	●	●
12ch		JCSS 校正 12ch 3点 10回測定	¥28,000	●			●	
	★	JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 合否判定付き	¥43,000	●			●	●
		JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 調整前校正付き	¥54,000	●	●		●	
	★	JCSS 校正 12ch 3点 10回測定 調整前校正+合否判定付き	¥70,000	●	●	●	●	●